



Držák měřicího zařízení a adaptér série HMI, A-HMI

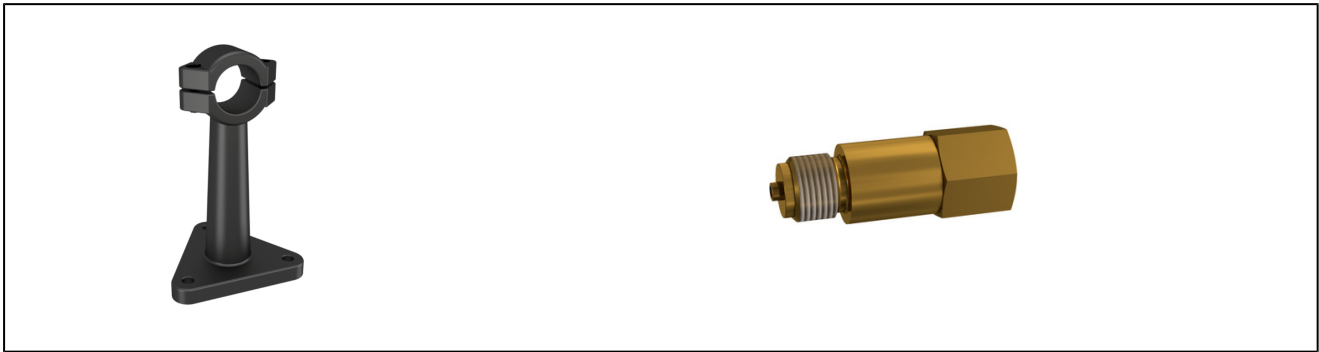


konstrukce	Držák měřicího zařízení dle DIN 16281 forma H a Mezikus pro držák měřicího zařízení dle DIN 16281
materiály	viz. tabulka
způsob upevnění	upevnění na zeď
doporučení pro použití	K připevnění manometru je třeba zařadit mezikus

Držák měřicího zařízení

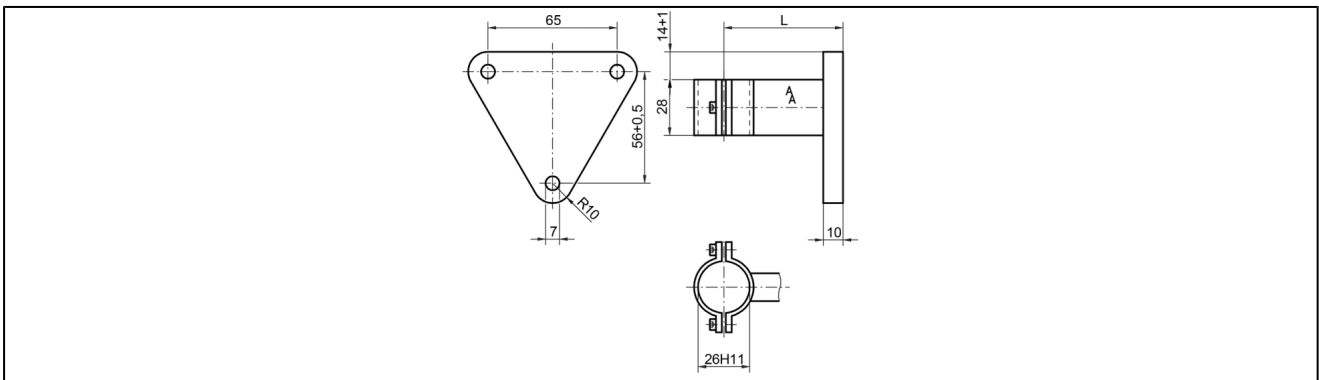

L	materiál	hmotnost [kg]	typ
60	hliník černě lakovaný	0,15	HMI-A-60
100	hliník černě lakovaný	0,18	HMI-A-100
160	hliník černě lakovaný	0,26	HMI-A-160
60	nerez 1.4571	-	HMI-W-60
100	nerez 1.4571	-	HMI-W-100
160	nerez 1.4571	-	HMI-W-160

adaptér

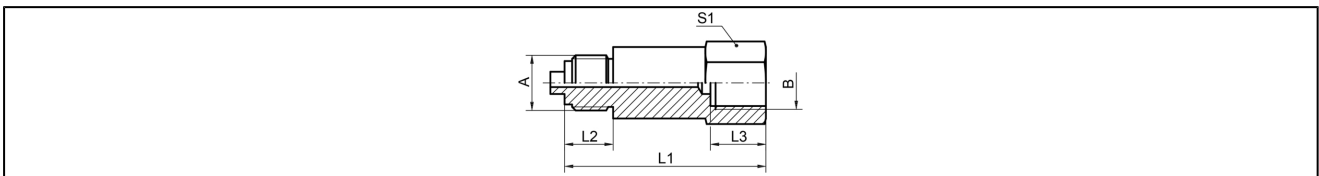

připojení A, B	materiál	rozsah teploty [°C]	PN	L1	L2	L3	S1	hmotnost [kg]	typ
G1/2"	mosaz	-20...120	250	75	20	18	27	0,25	A-HMI-B
G1/2"	ocel	-20...200	400	75	20	18	27	0,23	A-HMI-C
G1/2"	nerez 1.4571	-20...200	400	75	20	18	27	0,23	A-HMI-W

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.